

# 入札公告

平成28年1月15日

独立行政法人労働安全衛生総合研究所  
理事長 小川 康 恭

## 1 競争入札に付する事項

件名及び数量

耐圧型燃焼試験装置の製作 一式

## 2 競争参加資格に関する事項

- (1) 契約を締結する能力を有しないと認められる者又は破産者で復権を得ていない者でないこと。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助者であつて、契約締結のために必要な同意を得ている者はこの限りではない。
- (2) 以下の一に該当すると認められる場合は、その事実があつた後2年間を経過している者であること。なお、これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても同様とする。
  - ① 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者。
  - ② 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正な利益を得るために連合した者。
  - ③ 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者。
  - ④ 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者。
  - ⑤ 正当な理由が無くて契約を履行しなかった者。
  - ⑥ ①～⑤の一に該当する事実があつた後2年間を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他使用人として使用した者。
- (3) 平成25・26・27年度の厚生労働省競争参加資格（全省庁統一資格）において、厚生労働省大臣官房会計課長より「物品の製造」又は「物品の販売」においてA、B、C又はD等級に格付けされている者。
- (4) 官庁から指名停止を受けている期間に該当しない者。

## 3 入札及び開札

### (1) 入札書の提出

入札書は、郵便若しくは信書便による送達（以下「郵送等」という。）又は入札会場への持参により受け付ける。

ただし、郵送等の場合には、書留郵便等の配達記録が残るもので開札日当日の午前10時00分までに必着のこと。

### (2) 入札及び開札の日時、場所

日時：平成28年2月4日（木）午後2時00分

場所：住所 東京都清瀬市梅園1-4-6  
独立行政法人労働安全衛生総合研究所  
本部棟3階 総務課会議室

※入札者が開札に立ち会わない場合には、FAXにて結果をお知らせします。

#### 4 仕様書に対する質問

仕様書に対する質問がある場合は、次に従い提出することができる。

- (1) 受付期間及び方法  
平成28年1月28日(木)午後5時00分  
FAX(A4、様式自由)にて受け付ける。
- (2) 受付先  
東京都清瀬市梅園1-4-6  
独立行政法人労働安全衛生総合研究所総務部総務課 経理第一係  
FAX:042-491-7846
- (3) 回答  
平成28年2月1日(月)までに回答する。

#### 5 その他

- (1) 入札保証金に関する事項  
入札保証金の納付を免除する。
- (2) 入札の無効  
上記2に示した競争参加資格を有しない者のした入札は、これを無効とする。
- (3) 契約書作成の要否  
要。
- (4) 契約に係る情報の公表に関する事項

独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところである。

これに基づき、別紙のとおり、当研究所との関係に係る情報を当研究所のホームページで公表することとするので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行うこと。

なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなすので、ご了承ください。

以上

## <独立行政法人の契約に係る情報の公表>

独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。

これに基づき、以下のとおり、当研究所との関係に係る情報を当研究所のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。

なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了承ください。

### (1) 公表の対象となる契約先

次のいずれにも該当する契約先

- ① 当研究所において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること
  - ② 当研究所との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること
- ※ 予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水費の支出に係る契約等は対象外

### (2) 公表する情報

上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額、法人番号等と併せ、次に掲げる情報を公表します。

- ① 当研究所の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当研究所OB)の人数、職名及び当研究所における最終職名
- ② 当研究所との間の取引高
- ③ 総売上高又は事業収入に占める当研究所との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨  
3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上
- ④ 一者応札又は一者応募である場合はその旨

### (3) 当方に提供していただく情報

- ① 契約締結日時時点で在職している当研究所OBに係る情報(人数、現在の職名及び当研究所における最終職名等)
- ② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当研究所との間の取引高

### (4) 公表日

契約締結日の翌日から起算して原則として72日以内(4月に締結した契約については原則として93日以内)

### (5) その他

応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしただけでない相手方については、その名称等を公表させていただくことがありますので、ご了承ください。

## 入札説明書

- 1 競争に付するもの  
耐圧型燃焼試験装置の製作 一式
- 2 業務の内容・規格・数量  
仕様書のとおり
- 3 納入期限及び場所  
期限 平成28年3月25日  
場所 独立行政法人労働安全衛生総合研究所（清瀬地区）  
化学安全実験棟 第二燃焼実験室
- 4 支払条件  
物品納入の確認をもって支払うものとする。
- 5 入札心得
  - (1) 入札価格は、本件の履行に係る費用の総額に消費税等相当額を加えた金額とする。
  - (2) 落札者は、当法人の定める予定価格の制限の範囲内で最低価格を提示した者とし、当該入札価格をもって落札価格とする。
  - (3) 入札書の形式は任意とする。（別紙様式1）
  - (4) 入札書の宛名は「独立行政法人労働安全衛生総合研究所理事長」とすること。
  - (5) 入札書には、社名及び代表者名の記入、社印及び代表者印を押印すること。
  - (6) 代表者以外の者が入札する場合は、委任状を持参すること。（別紙様式2）
  - (7) 入札書における金額訂正は行わないこと。
  - (8) 入札の最低価格が予定価格を超えている場合はその場で再度入札を行うので、そのための入札書を用意すること。なお、郵送等による入札の場合は、以下のとおりとする。
    - ① 再度入札を行う際に参加を希望する場合は、あらかじめ複数の入札書を送付すること。入札書を封筒に入れ封印し、かつその表面に社名及び「開札日『入札件名』の入札書在中」と記載し、初度入札の入札書在中の封筒には「1回目」と、再度入札の入札書在中の封筒には「2回目」と記載して、それらをまとめて別の封筒に入れ、送付すること。
    - ② 再度入札を行う際に参加を希望しない場合は、入札書を1通のみ送付すること。
  - (9) 落札とすべき同額の入札をした者が2人以上いるときは、直ちに当該入札参加者にくじを引かせ、落札者を決定する。
- 6 入札者に求められる義務  
この入札に参加を希望する者は、入札公告2（3）の競争参加資格を有することを証明する書類を入札書と合わせて提出しなければならない。
- 7 その他  
入札説明書についての不明点、入札書類等に関することは独立行政法人労働安全衛生総合研究所総務部総務課経理第一係に問い合わせること。  
電話 042-491-4512 塩見（内線229）

# 入 札 書

独立行政法人労働安全衛生総合研究所 理事長 殿

1 件 名 「耐圧型燃焼試験装置の製作 一式」

2 金 額 ￥ — (税込)

上記のとおり入札いたします。

平成28年 月 日

入札者 住 所  
会 社 名  
代表者名  
代理人名

印  
印

# 委任状

独立行政法人労働安全衛生総合研究所 理事長 殿

は を代理人と定め、下記の行為を行う権限を委任します。

## 記

1 委任する行為

「耐圧型燃焼試験装置の製作一式」の一般競争入札に係る入札書の提出に関する一切の行為

2 委任する期日

平成 年 月 日

平成28年 月 日

住 所  
会 社 名  
代 表 者  
代理人名

印  
印

## 仕様書

### 1. 件名

耐圧型燃焼試験装置の製作 一式

### 2. 装置の概要

当該装置は、雰囲気制御した密閉系で可燃性粉じんの燃焼性状を観察・測定できる、光学ガラス窓付き耐圧型の燃焼容器である。容器には、試料台を毎回出し入れするためのふたが上面に、燃焼生成物の定期的な掃除除去のためのふたが下面に取り付けられている。ただし、両ふたはボルト締結とする。容器の側面には、測定センサー、ガス置換用の接続口が取り付けられている。また、装置全体は鉛直と水平に設置できる。

### 3. 装置の使用目的

当該装置は、雰囲気（酸素濃度と初期圧力）を制御した場でマグネシウム等の金属粉じんを燃焼させ、爆発と火災の危険性、消炎効果を試験するため用いる。

### 4. 装置の構成

装置の基本構成は燃焼容器と架台から構成される。

### 5. 装置の寸法と仕様

別紙の図を参照。

#### 1)燃焼容器

- ・材質：ステンレス
- ・容積：38L 以上 40L 未満
- ・円筒部：250A 10K

長さ；600mm。ただし、円筒部の板厚、ふた（鏡板）、ガラス窓の構造等のため、設計上、容積が 40L 以上となる可能性がある場合は、容積の上限を優先する。その際は、円筒部の長さでソケット位置は発注者と相談して定める。

- ・耐圧：0.95MPa
- ・安全弁を任意位置に取り付ける。
- ・ガラス窓：形状；楕円または矩形とし、長辺 200mm，短辺 52mm とする。  
材質；光学用硬質（強化）ガラス
- ・ソケット部にはプラグ用のねじを取り付ける。パッキンやシールテープを含む。

#### 2)架台

- ・燃焼容器と架台は固定する。
- ・架台ごと燃焼容器は鉛直と水平に置けること。ただし、水平置きの場合は対向するガラス窓が水平となるようにする。

- ・キャスター付き
- ・吊り上げ用のアイボルトを取り付ける。

6. 気密試験

空気圧,あるいは水圧で気密試験を行い,漏れや装置の破損がないことを確認すること。


7. 納期

平成 28 年 3 月 25 日

8. 納入場所

東京都清瀬市梅園 1 丁目 4 番 6 号  
独立行政法人労働安全衛生総合研究所  
化学安全実験棟 第二燃焼実験室



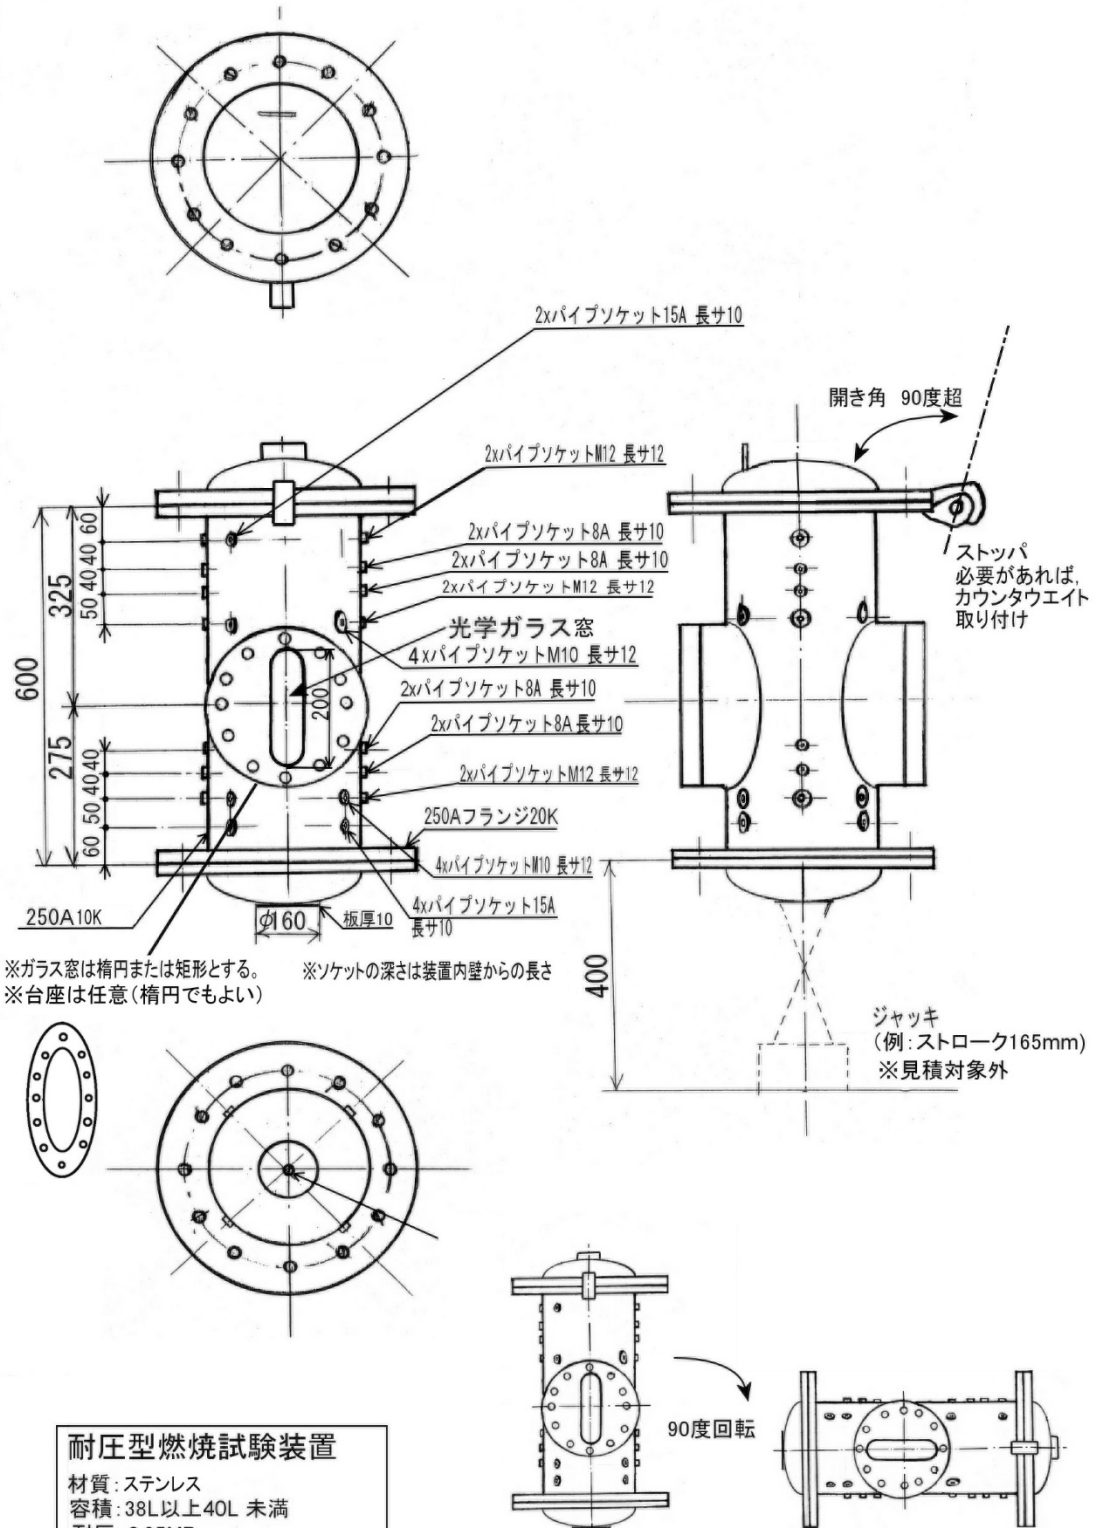

※ガラス窓は楕円または矩形とする。 ※ソケットの深さは装置内壁からの長さ  
 ※台座は任意(楕円でもよい)

**耐圧型燃焼試験装置**  
 材質: ステンレス  
 容積: 38L以上40L 未満  
 耐圧: 0.95MPa  
 安全弁: あり(任意位置)  
 ガラス窓: 光学用硬質(強化)ガラス  
 形状は楕円または矩形。  
 ただし長辺200mmx単辺52mm  
 架台: 燃焼容器と架台は固定する。  
 燃焼容器を鉛直、  
 水平に置けること。  
 (対向するガラス窓が水平となる)  
 キャスター付き  
 その他: ソケットねじ部にはプラグねじ(パッキン  
 あるいはシールテープを含む)を取り付ける。

※燃焼容器と架台は固定しており、  
 実験室内のホイスト式クレーンで吊  
 り上げ、架台ごと90度回転する。  
 架台中で燃焼容器を90度回転させ  
 る機構は必要なし。

(独)労働安全衛生総合研究所

図 装置概要